



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
KAMU HASTANELERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TIBBİ SARF MALZEME ÜRÜN EKLEME TALEPLERİ VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Hülya BULUT ADIYAMAN

SPESİFİK CERRAHİ BİRİMLERİ ÜRÜN
UZMANI

2024




ÜRÜN EKLEME TALEPLERİ VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Sağlık Market sistemine dahil olmak isteyen tedarikçilerin DMO Sağlık Market modülü üzerinden başvuru yapması sonrası yapılan işlemlerdir



Ürün Ekleme Talep İşleyişi

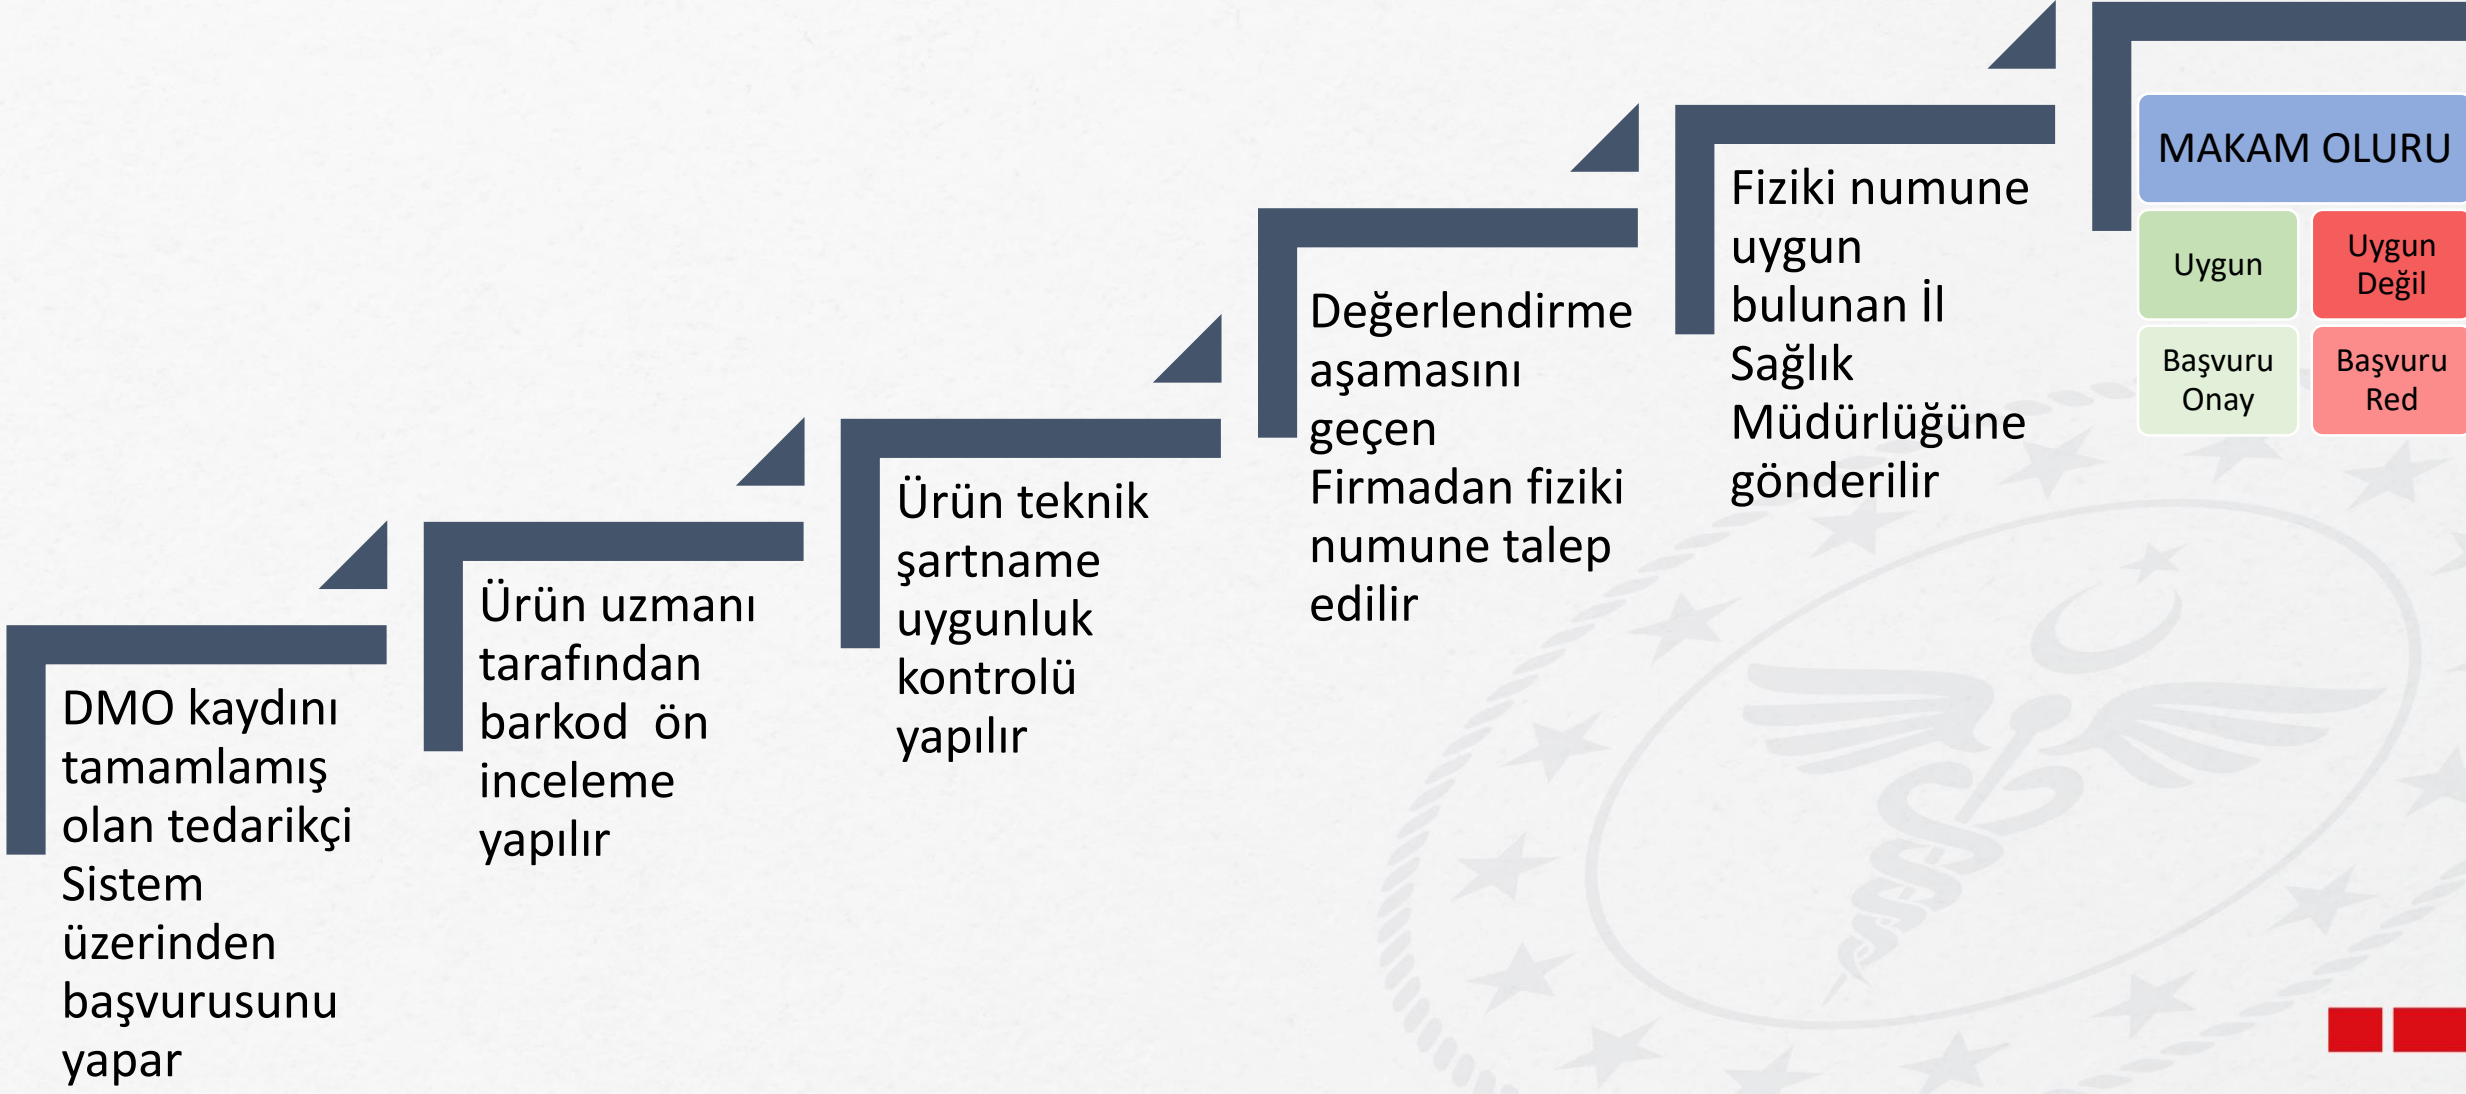



Tıbbi Sarf Başvuru Değerlendirme İşlemi Nasıl Yapılır ?

Sağlık Market Yönetimi Tıbbi Sarf Başvuru Değerlendirme İşlemi Bu sayfada tıbbi sarf başvuru taleplerini değerlendirebilirsiniz

Anasayfa > Sağlık Market Yönetimi Tıbbi Sarf Başvuru Değerlendirme

Şartname Listesi
Şartname Seçiniz

Kategori Listesi
Kategori Seçiniz

Sut Kodu Listesi
SUT Kodu Seçiniz

AbcVed Analiz Listesi
AbcVed Analiz Değeri Seçiniz

Filtrele Sıfırla

Sayfada 10 kayıt göster Ara:

Talep Numarası	Firma Adı	Talep Tarihi	Ürün Sayısı	Kategori Adı	Durum	Detaylar
45491	2667269078672 - RB ÇÖZÜM MEDİKAL TIBBİ ÜRÜNLER TEMİZLİK İNŞAAT HIRDAVAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	2.10.2023 13:38:10	3	ÜROLOJİ	Firma Geri Gönderdi	Detay
45476	2667269011143 - YÜ-CE TIBBİ GEREÇLER İTH. İHR. MÜMES. SAN. VE TİC. A.Ş.	3.10.2023 10:16:48	66	TEMEL SARF	Yeni Başvuru	Detay
44890	2667269012896 - ER-DOĞU PAZARLAMA TIBBİ MALZEME İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ	15.09.2023 10:22:46	16	CERRAHİ SARF	Yeni Başvuru	Detay
44669	2667269348421 - ADAMED İLAÇ MEDİKAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	8.08.2023 14:48:04	84	KALP VE DAMAR CERRAHİSİ KARDİYOLOJİ RADYOLOJİ VE GİRİŞİMSEL	Firma Geri Gönderdi	Detay
35880	2667269068584 - TUNA MEDİKAL TIBBİ CİHAZLAR SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	27.03.2024 17:47:23	7	CERRAHİ SARF - TEMEL SARF	Yeni Başvuru	Detay

165 kayıttan 161 - 165 arasındaki kayıtlar gösteriliyor

İlk Önceki 1 ... 13 14 15 16 17 Sonraki Son



Sağlık Market Yeni Başvuru Detayı

Tanımlayıcı Bilgiler

Ürün Tanımı:	Draeger - YOK - Ventstar Oxylog 3000 serisi ve 2000 plus 150 x5, Solunum devresi, tek kullanımlık
Birincil Ürün Numarası:	04048675000174 (GS1)
Firma:	2667269013248 - DRAEGER MEDİKAL TIC. VE SERVİS A.Ş. (Üretici/İthalatçı/Bayı/İhracatçı)
Marka:	Draeger
Ürün Adı:	Ventstar Oxylog 3000 serisi ve 2000 plus 150 x5, Solunum devresi, tek kullanımlık
Ürün Künyesi:	Ürün Künyesi.pdf
Türkçe Etiket:	Türkçe Etiket.pdf
Versiyon/Model:	YOK
Referans/Katalog No:	5703041
İçerikteki Ürün Sayısı:	1
Ürün Açıklaması:	

Sınıflandırma Bilgileri

Sınıf:	Sınıf-IIb
ÇMDN:	37706 - Solunum devresi, ventilatör, tek kullanımlık
Branş Türü Kodu:	363-HASTA DEVRESİ

SUT Kodları

SUT Kodu:	OR2690
-----------	--------

Ürün Görselleri

Ürün Görsel Dosyası	İT
5703041-3.jpg	
5703041-1.jpg	
5703041.jpg	
5703041-2.jpg	

Durum	İşlem
Q Gerekçe	Onayla Reddet Geri Gönder
Q Gerekçe	Onayla Reddet Geri Gönder
Q Gerekçe	Onayla Reddet Geri Gönder

- Birincil ürün numarası
- Ürün açıklaması
- Ürün tipi
- Takip numarası
- Firma Yetki tipi
- SMT Numarası
- Sut kodu
- Kategori
- Ambalaj içi miktar
- Malzeme Kodu ve Adı
- Durum (gerekçe)
- İşlem (onayla, reddet, geri gönder)



SUT Kaydı Sorgulama



Türkiye Cumhuriyeti
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU



Online Tıbbi Malzeme Sorgulama

SUT Koduna Göre Tıbbi Malzeme Sorgulama

Günün Tarihine Tıbbi Malzeme Sorgulama

Malzeme Sorgulama Bilgileri

Barkod :	<input type="text" value="08032979794729"/>
Firma Tanımlayıcı No :	<input type="text" value="2667269001252"/>
	<input type="button" value="Sorgula"/>

Bu sayfada yapılan sorgulamalarda kullanılan veriler; Kurumumuzca herhangi bir değerlendirilmeye tabi tutulmaksızın firmaların kendi beyanları doğrultusunda yaptıkları SUT kodu-barkod eşleştirmelerden oluşmaktadır. Bu ekrandan yapılacak olan sorgulamalar tek başına ödemeye esas olmamakla birlikte, yalnızca barkodların eşli buldukları SUT kodlarını bilgi amaçlı göstermektedir.

İşlem Malzemeleri

Sut Kodu ⇅	Sut Adı	Sut Liste Kodu	Sut Fiyatı
HO1020	SEPSİS ADSORBSİYON KOLONU	EK30	20010.38

Sağlık hizmeti sunucuları ürünün SUT ve eki listelerdeki geri ödeme kural ve kriterlerini de göz önünde bulundurmalıdırlar.

Sosyal Güvenlik Kurumu Medula Sisteminde Barkod Numarası ve Firma Tanımlayıcı numarası ile SUT Kaydı Sorgulaması yapılır.



Ana Tedarikçisi yada bayisi tarafından daha önce incelenip onaylanan barkodlu ürünler DMO Sağlık Market Başvuru ekranlarında ★ ikonunu ile belirtilmektedir.

✖ SMT Bazında Reddet ↩ SMT Bazında Geri Gönder ✓ SMT Bazında Onayla ↩ SMT Bazında İşlemi Geri Al

Ara:

Sayfada kayıt göster

Takip Numarası	Birincil Ürün Numarası	Ürün Açıklaması	Firma Yetki Tipi	SMT Numarası	Sut Kodu	Kategori	Ambalaj İçi Miktar (İçerikteki Ürün Sayısı)	SM Numarası-Adı	İşlem
		DİCAL CARE - YOK - EPRO-KİT Cİ-CA HDF 1000	Bayi	SMT1747	NF1016, NF1017	NEFROLOJİ	0	SMT1747.270005570 Sürekli Renal Replasman Tedavi Seti, Hemofiltre Dahil	Onaylandı ↩ İşlemi Geri Al
		DİCAL CARE - YOK - EPRO-KİT Cİ-CA HD 1000	Bayi	SMT1747	NF1016, NF1017	NEFROLOJİ	0	SMT1747.270005570 Sürekli Renal Replasman Tedavi Seti, Hemofiltre Dahil	Onaylandı ↩ İşlemi Geri Al
		DİCAL CARE - YOK - EPRO-KİT HDF 1000	Bayi	SMT1747	NF1016, NF1017	NEFROLOJİ	0	SMT1747.270005570 Sürekli Renal Replasman Tedavi Seti, Hemofiltre Dahil	Onaylandı ↩ İşlemi Geri Al

3 kayıttan 1 - 3 arasındaki kayıtlar gösteriliyor

İlk Önceki Sonraki Son

[Başvuruyu Tamamla](#)

Bilgi Notu
★ Bu ürün daha önce onaylandı.



FİZİKİ NUMUNE TALEP İŞLEMİ

Takep Numarası	Birincil Ürün Numarası	Ürün Tipi	Ürün Açıklaması	Firma Yetki Tipi	SMT Numarası	Sut Kodu	Kategori	Ambalaj İçi	Durum	İşlem
430928	8906155700852	UROMED - YOK - DRENAJ SETİ,SUPRAPUBİK (SİSTOSTOMİ SETİ),SİLİKON,BALON,16F,40CM	Göster	Uretici	SMT1688	UR1064	ÜROLOJİ	Gereke Sayın yetkili; ürününüz Ürün açıklaması yetersiz veya yanlış.;Ürün görseli ile sıkıntı bulunmaktadır.;SUT Kodu yanlış.;UBB barkodu ile görseldeki barkod uyumsuz. Sayın İlgili başvurudaki ürünün Sağlık Market Sitemine tedarikçi olarak dahil edilebilmesi için "İlk Numune Değerlendirme" yapılacaktır. Ürün alanında uzman komisyon üyelerinin incelemesi sonucunda bağlı bulunduğu sut koduna ve şarnameye uygun bulunması durumunda, onay formu düzenlenerek sisteme dahil edilecektir. Bu minvalde her barkodtan üçer adet numunenin ve katalog belgelerinin resmi yol yolla Kamu Hastaneler Genel Müdürlüğü Tedarik Planlama Stok ve Lojistik Yönetimi Daire Başkanlığına gönderilmesi rica olunur. gerekeşi ile geri gönderilmiştir. Bilgilerinize sunulur.	Gereke	Onayla Reddet Geri Gönder
430927	8906155700845	UROMED - YOK - DRENAJ SETİ,SUPRAPUBİK (SİSTOSTOMİ SETİ),SİLİKON,BALON,14F,40CM	Göster	Uretici	SMT1688	UR1064	ÜROLOJİ		Gereke	Onayla Reddet Geri Gönder
430925	8906155700838	UROMED - YOK - DRENAJ SETİ,SUPRAPUBİK (SİSTOSTOMİ SETİ),SİLİKON,BALON,12F,40CM	Göster	Uretici	SMT1688	UR1064	ÜROLOJİ		Gereke	Onayla Reddet Geri Gönder




Fiziki Numuneler

- İlgili ürün sorumlusu tarafından evrak kaydı kontrolü ile teslim alınır.
- Ürünün niteliği, Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi (MKYS) alım analizi, geçmiş Talep listelerindeki talep miktarları doğrultusunda değerlendirmeye gönderilecek il belirlenir.
- Değerlendirecek olan İl Sağlık Müdürlüğüne resmi yazı ile ürünler gönderilir.



Numune Değerlendirme Süreci

Fiziki Numuneleri Teslim Alan İSM Sorumlusu nasıl bir yol izlemeli

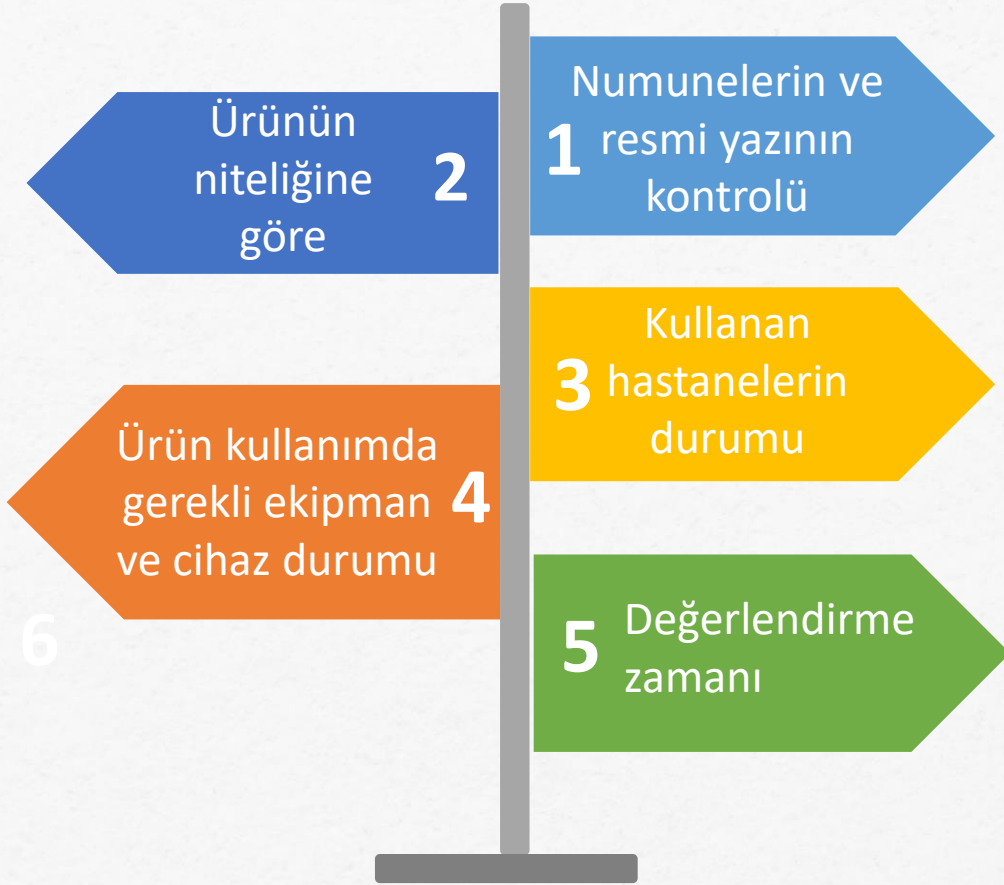

2 Ürün niteliğine göre değerlendirme yapabilecek sağlık tesisinin belirlenmeli

4 Ürün kullanımında gerekli aplikatör, monitör, sinir stimülatör cihazı, dilatasyon için pnömotik şişirme pompası, endoloop atıcısı, metal sheath, elektrik kablosu gibi yardımcı aparatları kontrolü

1 Numuneler ve resmi yazıda yer alan barkodlar kontrol edilmeli

3 Kurulacak komisyonda yer alacak uzman personel

5 Değerlendirme zamanı
En fazla 7 iş günü



Numune Değerlendirme Süreci

SMT1192 PORT KATETER, ATRAVMATİK İĞNELİ

SMT Temel İşlevi:	1. Port kateter sistemlerinde port rezervuarına güvenli giriş sağlamak üzere tasarlanmış olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. İğne setinin imal edildiği madde alerjik reaksiyonlara neden olan latex içermemelidir. 3. Kateterin iğne kalınlığı 19G, 20G, 22G, uzunluğu en az 13mm olmalıdır. 4. İğne rahat girişim için 90 derece eğimli olmalıdır. 5. İğnenin korumalı veya korumasız seçenekleri olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	6. İğne ucu, portun silikon septumuna zarar vermeyen non-coring (huber) uç yapısında olmalıdır. 7. İğne bağlantı yerleri basınca dayanıklı olacak ve sızdırma yapmayacak şekilde olmalıdır. 8. İğne ile bağlantı yeri basınçtan kaynaklı ayrılmamalıdır. Sağlam olmalıdır. 9. İğne özellikle sürekli infüzyon şartlarında kullanım için 15cm-25cm uzunluğunda anti-kink özellikli luer-lock bağlantılı uzatma hattına sahip olmalıdır. 10. Set distal ucunda luer bağlantı olmalı ve port iğnesine yıkama yapılabilmelidir.
Genel Hükümler:	11. Ürün steril ve tek kullanımlık olmalıdır. 12. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgileri olmalıdır.

Sağlık Tesisi Ürün - Şartname Değerlendirmelerde Nelere Dikkat Etmeli

SMT Temel İşlevi:

Ürünün kullanım endikasyonu ve işlevine uyumu

SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:

Ürünün ayırt edici özellikleri, tür ve sınıflandırılmasının yapıldığı bölüm

Teknik Özellikler:

Ürünün kullanımı için gerekli tüm standartların ve özelliklerin belirtildiği bölüm

Genel Hükümler:

Ürünün teslim standartlarının belirtildiği bölüm



Numune Değerlendirme Süreci

Sağlık Tesisi Ürün - Şartname Değerlendirmelerde Nelere Dikkat Etmeli

Düzenle Sil Pasif Yap	270009721	DRENAJ SETİ, SUPRAPUBİK (SİSTOSTOMİ SETİ), POLİÜRETAN, KIVRIK, 10F, 65CM
Düzenle Sil Pasif Yap	270014688	DRENAJ SETİ, SUPRAPUBİK (SİSTOSTOMİ SETİ), POLİÜRETAN, KIVRIK, 12F, 45CM
Düzenle Sil Pasif Yap	270009722	DRENAJ SETİ, SUPRAPUBİK (SİSTOSTOMİ SETİ), POLİÜRETAN, KIVRIK, 12F, 65CM
Düzenle Sil Pasif Yap	270014690	DRENAJ SETİ, SUPRAPUBİK (SİSTOSTOMİ SETİ), POLİÜRETAN, KIVRIK, 14F, 45CM
Düzenle Sil Pasif Yap	270009723	DRENAJ SETİ, SUPRAPUBİK (SİSTOSTOMİ SETİ), POLİÜRETAN, KIVRIK, 14F, 65CM
Düzenle Sil Pasif Yap	270014689	DRENAJ SETİ, SUPRAPUBİK (SİSTOSTOMİ SETİ), POLİÜRETAN, KIVRIK, 8F, 45CM
Düzenle Sil Pasif Yap	270002084	DRENAJ SETİ, SUPRAPUBİK (SİSTOSTOMİ SETİ), SİLİKON, BALONLU, 10F, 40CM
Düzenle Sil Pasif Yap	270002082	DRENAJ SETİ, SUPRAPUBİK (SİSTOSTOMİ SETİ), SİLİKON, BALONLU, 12F, 40CM
Düzenle Sil Pasif Yap	270007407	DRENAJ SETİ, SUPRAPUBİK (SİSTOSTOMİ SETİ), SİLİKON, BALONLU, 14F, 40CM
Düzenle Sil Pasif Yap	270007408	DRENAJ SETİ, SUPRAPUBİK (SİSTOSTOMİ SETİ), SİLİKON, BALONLU, 16F, 40CM

Ürün Tanımlama Bilgileri Alıma Esas olarak belirlendiğinden ve talep ve ihale süreçlerinde kullanıldığından ürün değerlendirme işlemlerinde bu tanımlara da dikkat edilmesi ve varsa eklenmesi gereken yeni tanımlama bilgilerinin de değerlendirme raporunda bildirilmesi gerekmektedir.



Numune Değerlendirme Süreci



T.C.
VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü



Sayı : E-75252626-949-241186858

22.04.2024

Konu : İlk Numune Değerlendirme (SMT
SMT1742-Hemodiyaliz Kateteri, Geçici)
3A Medikal

KAMU HASTANELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi : a) 06.12.2023 tarihli ve E-80981279-809.99-230777682 sayılı yazımız.
b) Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 26.03.2024 tarihli ve E-93471371-809.99-241186858 sayılı yazısı.

İlgi (a) kayıtlı yazımıza istinaden, 3A Medikal Sanayi ve Ticaret A. Şirketi'ne ait 45318 başvuru numaralı "SMT1742-Hemodiyaliz Kateteri, Geçici" 6221139065133 (6F 8cm) barkod numaralı ürün değerlendirilmek üzere Müdürlüğümüze bağlı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderilmiştir. Ancak hastanede Çocuk Nefroloji Kliniği olmadığı bue bahse konu ürünün değerlendirilemediği ilgi (b) yazısı ile bildirilmiş olup, ürün tarafımıza iade edilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

SMT1722- Arter- ven seti, hemodiyaliz için şartnamede belirtilen temel işlev, malzeme tanımlama bilgileri, teknik özellikler ve genel hükümler gönderilen numunelerle uyumlu olmakla beraber ;

1.Temel işlev için uygundur.

2.Malzeme tanımlama bilgilerinden

- ✓ 2.Madde; uygundur
- ✓ 3. Madde set ile birlikte verilmeli ibaresine rağmen set ile birlikte bağlanmış şekilde gelmiş olup, set poşeti açılırken iyi sıkıştırılmadığında bir izolatör yere düşmüştür. Uygun değildir.
- ✓ 4.Madde ;uygundur.
- ✓ 5.Madde uygundur.
- ✓ 6.Madde ;arter hattı üzerinde bulunan infüzyon hattının arter yastığının üstünde bulunması hemodiyaliz tedavi esnasında uygulanabilirliği mümkün olan ilaç,eritrosit süpsansiyonu ,total parenteral nutrisyon gibi infüzyon tedavileri takiplerinde kan pompası durması ve ilaç bitimi sırasında hava kontrolü sağlanamayabileceğinden dolayı uygun değildir.
- ✓ 7.Madde ;uygundur.
- ✓ 8.Madde; arter yastığı hastanın kateter girişinin üstünde yeterli yastığı durumlarda kollebe olabilecek yumuşaklıkta değildir ve yastıkçıklarında bulunan infüzyon pompası gönderilen mayi basınçları nedeni ile yastıkçıkların durumu değerlendirilememektedir, bu nedenle uygun değildir.
- ✓ 9.Madde; dripchamber alt bağlantı yerlerinde gönderilen 3 numunede de ele gelen plastik deformasyonlar mevcuttur.Elle hissedilmekte ve gözle görülmektedir.Poşetten çıkarıldığında dripchamber alt kısımları iki numunede de tamamen kıvrık durumda çıkmıştır.Bu kıvrımlar iç hacmi daraltmaktadır.Tedavi hazırlık öncesi ve sonrası manuel düzeltmeye çalışılsada ,düzeltiminde zorlanılmıştır.Tedavi hazırlık aşamasını uyguladıktan ve tedavi başladıktan sonra Düzeltilemeyen kıvrımlar pıhtılaşmaya ve hemolize sebebiyet verebileceğinden uygun değildir .
- ✓ 10.11.12.13.14.Madde; uygundur.

3.Teknik özellikler uygundur

4.Genel Hükümler

- ✓ 18.Madde açılan paket içinde sette kırılma mevcuttur.Uygun değildir
- ✓ 19.20.21.22.23.Madde uygundur.
Rutin Hemodiyaliz tedavisi kullanımında yukarıda belirtilen zorlukların yaşanabileceği düşünüldüğünden setlerin bu haliyle pratikte kullanımı uygun olmadığı görüşündeyiz.



Herneke kaseti Herneke kaseti

Sağlık kuruluşlarımızdan numune değerlendirme sürecindeki uygunsuz ürünleri görsel ve video ile raporlamayı destekleyen sağlık tesislerimiz de bulunmaktadır.



Numune Değerlendirme Süreci

MAKAM OLURU

Uygun

Uygun Değil

Başvuru Onay

Başvuru Red

Tedarik Süreci



İLK NUMUNE TALEP DEĞERLENDİRMENİN ÖNEMİ

- Şartnamelere ve kullanıma uygun ürünlerin Sağlık Market sistemine dahil edilmesi
- Doğru fiyata kaliteli ürün tedarikinin sağlanması
- Doğru tanımlama ve malzeme eşleşmesi yapılabilmesi
- Sisteme dahil edilen ürünlerin aynı kategorideki ürünler ile ihale edilebilmesi için doğru eşleşme sağlanması
- Uygunsuz ve olumsuz olay yaşanmasının önlenmesi ve yazışma yoğunluğunun azalması



İLK NUMUNE DEĞERLENDİRME SONUÇ GRAFİĞİ

Tedarikçiler tarafından yapılan 402.124 adet barkod başvurusu incelenmiş ve 198.355 adet barkodun Sağlık Market Üzerinden tedarik edilmesine onay verilmiştir.

Tedarik Planlama Birimi olarak “İlk Numune” değerlendirme algoritmasını başlatmamış olsaydık uygunsuzluk ve olumsuz olaylar ile ilgili yaşayacağınız zorlukları düşününüz.

3010

1187

664

424

372